

A quién hacer el Test Rápido Estrep A

No es posible diferenciar, por la clínica y la exploración, una Laringitis viral de una bacteriana. Tampoco las que están producidas por el Estreptococo pyogenes u otras bacterias. Necesitamos técnicas de diagnóstico para identificar la única Laringitis que nos interesa, desde el punto de vista terapéutico, en Atención Primaria. Una de ellas es el test rápido de detección del antígeno estreptocócico del grupo A. Sin embargo, hay que seleccionar a los pacientes a los que se les va realizar esta prueba. Así:

No hacer sistemáticamente el Test Estrep A:

A los menores de 3 años con Laringitis salvo que:

Tenga contacto en casa conocido de familiar afecto de Laringitis por Estreptococo BHGA.

Existe un brote de Laringitis por Estreptococo BHGA en la guardería a la que asiste.

A los mayores de 3 años con faringitis aguda y cualquiera de las siguientes manifestaciones clínicas:

- Rinitis
- Conjuntivitis
- Ronquera
- Tos
- aftas o lesiones ulcerativas mucosa bucal
- diarrea


Hacer sistemáticamente el Test Estrep A:

A los mayores de 3 años con Laringitis aguda y cualquiera de las siguientes manifestaciones clínicas:

- dolor de garganta
- odinofagia
- fiebre
- exudado faríngeo
- adenopatías cervicales anteriores exantema

contacto conocido con un paciente diagnosticado de faringoamigdalitis por Estreptococo BHGA


Algoritmo en el de la manejo faringoamigdalitis aguda

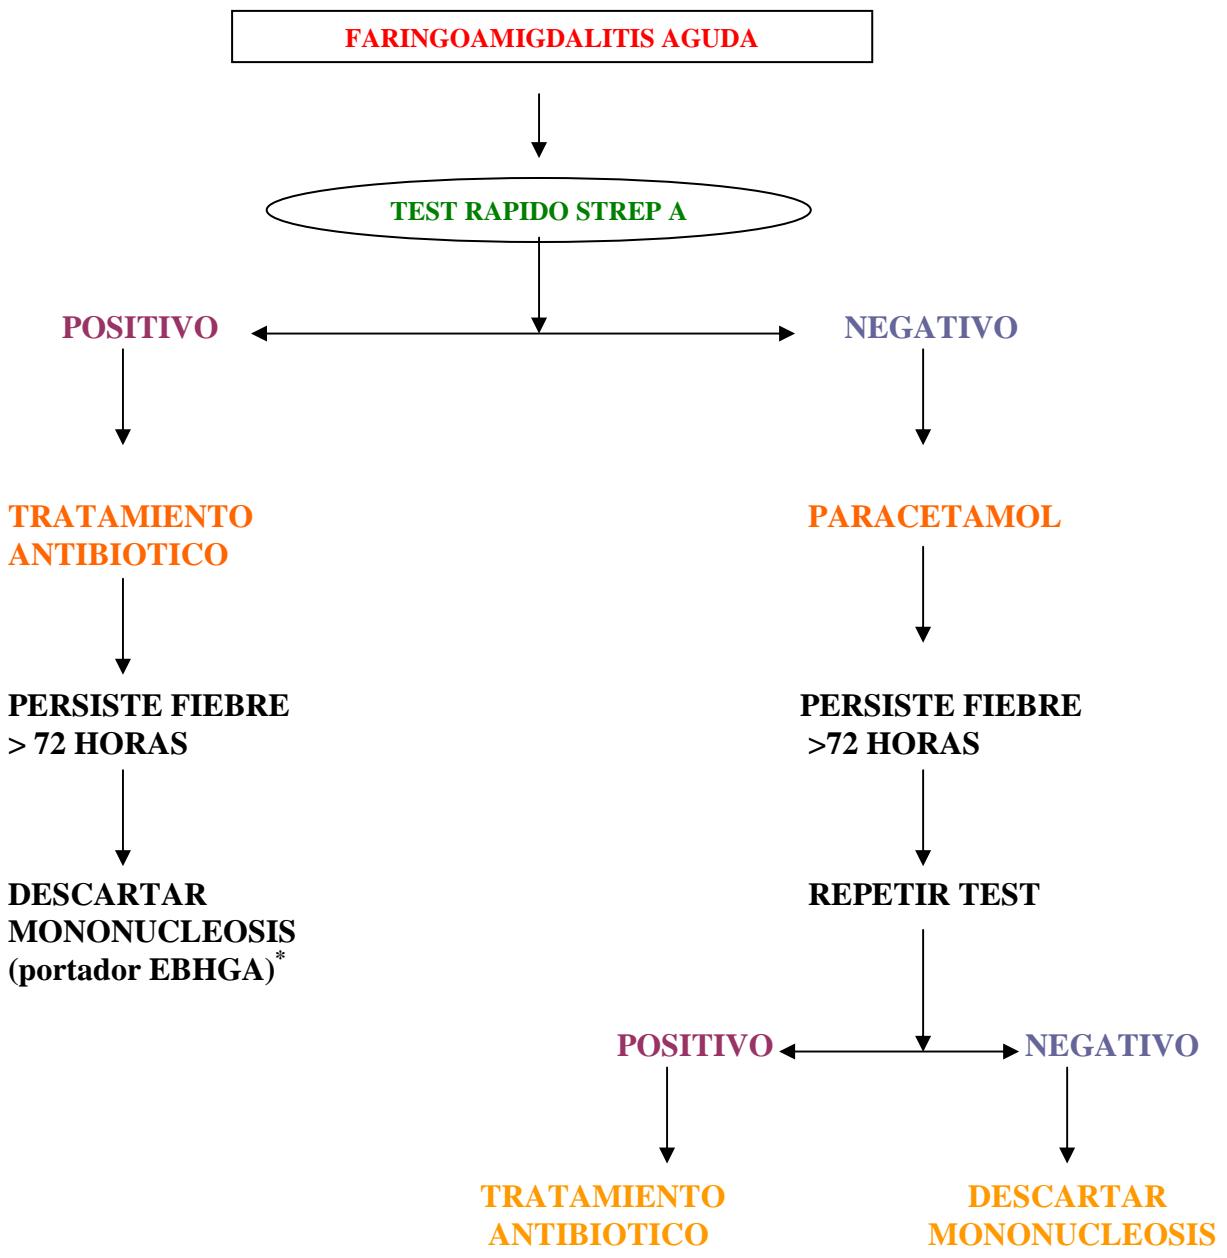

*Un paciente en estado de "portador" de Estreptococo BHGA puede dar positivo en el test y tener una faringitis producida por otra bacteria o virus.

Algoritmo en el manejo faringoamigdalitis aguda

(paciente previamente diagnosticado de faringoamigdalitis estreptococica recurrente)

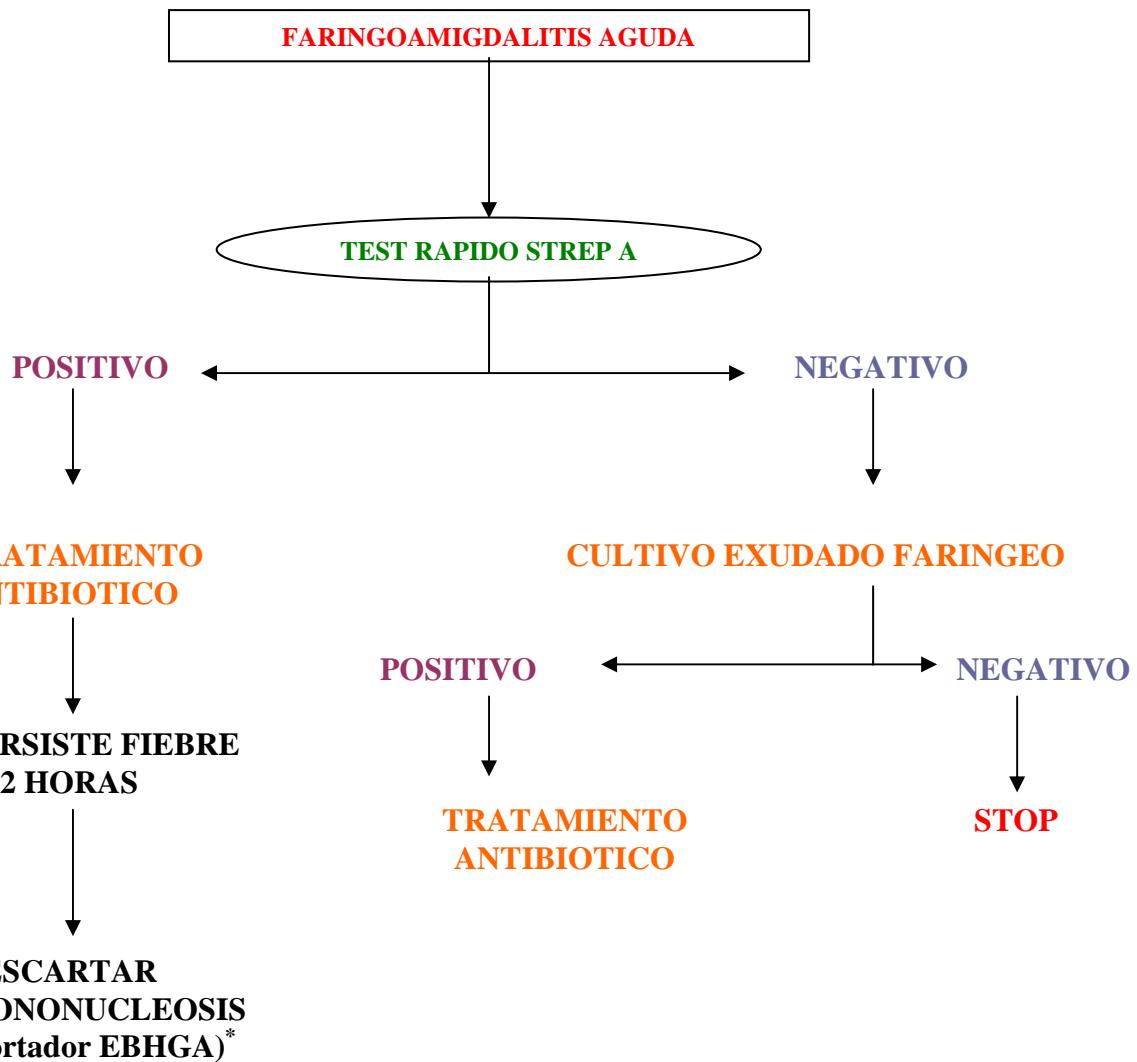

*Un paciente en estado de "portador" de Estreptococo BHGA puede dar positivo en el test y tener una faringitis producida por otra bacteria o virus.

Nota importante: cada vez que se abra un KIT del Test Estrep A, se deberá verificar la fecha de caducidad del lote. Ademas se realizara un test de prueba con los reactivos de control (negativo y positivo) para comprobar su correcto funcionamiento.